



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Fls. 428.8

“PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2020 – SRP

ENCERRAMENTO: 14/10/2020 – ÀS 09h00min.

ABERTURA: 14/10/2020 – ÀS 09h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIAIA / MS.


JARAGUÁ MERCANTIL – EIRELI

CNPJ: 13.390.706/0001-59

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

1

Fls. 479. K

Cambe (PR), 14 de Outubro de 2.020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Av. Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570 – Jardim Seriema
CEP: 79.995-000 – CORONEL SAPUCAIA / MS.

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2020 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 105/2020
ENCERRAMENTO: 14/10/2020 – ÀS 09h00min.
ABERTURA: 14/10/2020 – ÀS 09h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO....: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13022.375000/1190-02, SENDO QUE OS MATERIAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL SAPUCAIA/MS, EM CONFORMIDADE COM AS DESCRIÇÕES ELENCADAS NOS ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL (ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS / ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA).

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa proposta comercial de preços para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE – 01

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
006	001	UND	CAMA PARA PARTO PPP MANUAL MODELO: 1053 MARCA/FABRICANTE: "MARCA INDÚSTRIA" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 81325370001	R\$ 16.010,00	R\$ 16.010,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CAMA PARA PARTO PPP MANUAL


Especificações:

- Sistema PPP – Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.
- Movimentos: Elevação dorsal.
- Acionamento através de cremalheira;
- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.
- Acompanha grades em material termoplástico injetado.
- Rodízios de 4" sendo dois com freios em diagonal.
- Apoio de pernas removível;
- Par de porta coxas em aço inoxidável;
- Apoio para de calcanhares estofado;
- Barra de esforço em aço inoxidável;
- Dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável;
- Colchão tri-partido com revestimento e zíper para higienização.
- Capacidade máxima: 150 kg.
- Dimensões: 1,90 x 0,80 cm.

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Fis. 480. K

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
007	004	UND	CARRO PADIOLA ESMALTADO, LEITO ESTOFADO, COM GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO MODELO: RN-04020 MARCA: "RENAS CER" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80430259010	R\$ 2.509,00	R\$ 10.036,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRO PADIOLA ESMALTADO, LEITO ESTOFADO, COM GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO

Especificações:

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm.
- Leito fixo em chapa de MDF de 15mm, com espuma D26R revestido em Courvim.
- Cabeceira regulável através de cremalheira.
- Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm.
- Pára-choque de proteção na cabeceira e peseira do leito.
- Suporte para soro com 02 ganchos inox (T).
- Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal.
- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso.

Dimensão e Peso:

- Comprimento: 1900 mm
- Largura: 600 mm
- Altura: 800 mm
- Capacidade: Até 110 kg

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
009	001	UND	APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL "DR" FIXO 630MA X 150KV COM GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA 50 KW MODELO: DIAFIX HF MARCA: "CDK INDÚSTRIA" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80119610007 DETECTOR DE RAIOS-X DIGITAL DIRETO SEM FIO WIRELESS C/AREA ATIVA 17 X 17 (430 MM X 430 MM) MODELO: PIXX 1717 MARCA/FABRICANTE: "PIXXGEN CORPORATION" PROCEDÊNCIA: Coreia do Sul REGISTRO ANVISA: 10332510020	R\$ 315.660,00	R\$ 315.660,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO

APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL "DR" FIXO 630MA X 150KV COM GERADOR EM ALTA FREQUÊNCIA 50 KW

ESPECIFICAÇÕES:

Gerador de Alta Frequência:

- Gerador SHFR-500;
- **Potência do gerador: 50 KW;**
- Alimentação trifásica 220VAC ou 380VAC;
- Compensação automática de rede +/- 10%;
- Faixa de KVp de 40 a 150 KVp com ajuste de 1 KVp em 1 KVp;
- Faixa de mA de 10 a 630mA em 18 passos ;
- Faixa de mAs desde 0,1 a 630 mAs em 39 passos;
- Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos.


Mesa de Comando:

- Teclas Soft Touch que permitem selecionar individualmente, Kvp, mA, mAs, tempo de exposição;
- **Software Aquisição DROC**, possibilita registrar emergência, inserir comentários editáveis, pré-visualizar a imagem radiografada, guardar procedimentos incompletos, girar ou inverter imagem, recortar imagem ajuste e contraste e

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Fig 481.K

brilho, filtros diversos, exportação de imagens para gravar em CD/DVD, pré-visualização após 4 segundos.

- Mesa de comando para séries de geradores com DR (Radiografia Digital).
- Programador Anatômico - APR com mais de 530 técnicas editáveis.

Coluna Porta Tubo:

- Coluna tipo chão-chão com trilho de 3m;
- Rotação do tubo $\pm 180^\circ$;
- Freios eletromagnéticos liberados através de comando de freios na parte frontal do equipamento.

Mesa Bucky de Altura Fixa:

- Tampo flutuante com freios eletromagnéticos liberados através de pedal;
- Dimensões do tampo 200 x 74 x 80cm (C x L x A);
- Deslocamento longitudinal ± 50 cm;
- Deslocamento transversal ± 30 cm;
- Potter Bucky oscilante;
- Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;
- Grade antidifusora 10:1 103linhas/pol;
- SID 100 cm;
- Capacidade De Carga 300 Kg.

Bucky Mural:

- Freios mecânicos;
- Deslocamento vertical 125 cm;
- Potter Bucky oscilante;
- Bandeja porta chassi para 18x24cm a 43x43 cm;
- Grade antidifusora 10:1 103linhas/pol;
- SID 100 cm – 180cm.

Colimador Manual:

- Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;
- Rotação do colimador $\pm 180^\circ$ (+90°, 0° e -90°);
- Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente.
- Luz de LED.

TUBO DE RAIOS-X E77884X TOSHIBA:

Tensão Nominal do tubo de Raios-X:

- 40 x 150 kV;

Corrente máxima do tubo de raios-x (Potencial Constante, Alta Velocidade):

- Foco maior: 700 mA;
- Foco menor: 300 mA;

Valor Nominal do Ponto Focal:

- Foco maior (grosso): 1,2 mm.
- Foco menor (fino): 0,6 mm.

Potência:

- Foco maior 50Hz / 60Hz / 50 kW / 54 kW.
- Foco menor 50Hz / 60Hz / 20 kW / 22 kW.

Objetivo:

- Ângulo do anodo: 12°.
- Diâmetro: \varnothing 74 mm.

Velocidade de Rotação do Ânodo:

- A baixa Velocidade (50 Hz): 2.700 r.p.m.
- A baixa Velocidade (60 Hz): 3.200 r.p.m.

Fuga do fator de técnica radiográfica:

- 150 kV, 3,4 mA.

Filtração Permanente do Tubo de Raios-X:

- 0,9 mm Al / 75kV.

Características Térmicas:

- Índice Calorífico do Ânodo: 210 kJ (300 kHU);
- Dissipação Máxima de Calor do Ânodo: 870 W (1226 HU/s);
- Índice Calorífico do Conjunto do Tubo de Raios-X: 900 kJ (1.250 kHU);
- Dissipação máxima de calor contínua: 180 W (15 kHU/min);


Referência do Modelo de Armação do Tubo:

- Xh-121.

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELLI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

4

Fls. 482 - R

Intervalo Normal de Funcionamento da Temperatura da armação:

- 16 ~ 75°C.

Método de Arrefecimento:

- Ar natural ou ar forçado.

Dimensões e Peso do Conjunto do Tubo de Raios-X:

- Diâmetro Máximo: Ø 152,4 mm.
- Comprimento: 479 mm.
- Peso (aprox.): 16 kg.

Par de Cabo de Alta Tensão:

- Par de cabo de alta tensão de 150KV ultra flexível de 7 metros.

Empresa Certificada:

- ISO 9001/ 2008 e ISO 13485/2004.

ACOMPANHA (INCLUSO):

DETECTOR DE RAIOS-X DIGITAL DIRETO SEM FIO WIRELESS C/AREA ATIVA 17 X 17 (430 MM X 430 MM)

Especificações:

- O Detector Digital permite realizar exames radiográficos rapidamente e com excelente padrão de imagem, reduzindo a dose de exposição do paciente quando comparada ao CR ou filme.
- A grande evolução tecnológica na fabricação e dos componentes está proporcionando uma impulsão na atualização dos aparelhos de raios-x em todo o Brasil. A redução do custo operacional é muito grande, quando comparado com o uso do CR, uma vez que a produtividade é aumentada, não existe necessidade de troca periódica de IP (Chassis), a manutenção é mínima por não haver nenhum componente mecânico e ainda, proporciona uma sobre vida aos componentes do aparelho de raios-x por reduzir as técnicas operacionais.
- Para diminuir a manipulação do detector, este possui área ativa de 43 x 43 cm, permitindo que uma vez inserido na bandeja do potter bucky não haja necessidade de reposicioná-lo.
- O detector Pixx17x17 possui uma cobertura em fibra de carbono que torna o conjunto leve e principalmente muito resistente. Outro grande avanço é o acoplamento via cabo HDMI do detector à caixa de controle. Esta tecnologia reduz muito o custo de uma eventual troca de cabo e devido ao fato de não possuir baterias, a manutenção do detector é praticamente zero.
- Com a tecnologia TFT de aquisição de imagem, a mesma é transmitida ao computador em poucos segundos, otimizando o trabalho e proporcionando grande qualidade.
- A exclusiva tecnologia do Pixx17x17 proporciona grande redução de dose graças ao processamento interno do detector, seu sistema ajusta o ganho necessário para gerar imagens excelentes.
- Reduza os custos de manutenção com Chassis e com Chassis IP, o detector não necessita ser trocado constantemente, os leitores de CR podem danificar o chassi, isto não ocorre com a tecnologia DR.
- A instalação do Pixx17x17 é muito simples, seu avançado sistema de Auto Calibração (Auto Calibration Control) permite que este seja instalado em qualquer tipo de aparelho de Raios-x, com grande facilidade e sempre com a mesma qualidade.
- Com o sistema de Detecção Automática de Exposição (Automatic Exposure Detection) o detector sincroniza sem necessidade de comando ou interligação, captando a imagem e permanecendo em modo stand-by.


Características Técnicas:

- Detector digital "FLAT PANEL TFT" de radiologia direta "DR" com uma área ativa 17 x 17 polegadas (430 mm X 430 mm), sem fio Wireless a ser inserido na gaveta do potter bucky da mesa de exames de radiodiagnóstico e no potter bucky do mural bucky vertical, sem a necessidade de mudar a posição do detector na vertical e ou horizontal.
- **Aplicação:** Radiografia Geral para: Salas de Raios-X fixas, Atendimentos em leitos e UTI, sistemas moveis: Home Care/Veículos/Vans/Caminhões.
- Sensor: Detector de tela plana com matriz TFT a-Si.
- Tela de conversão: Cintilador CSI (IODETO DE CÉSIO).
- Sistema de detecção automática de exposição.
- Sistema de calibração automática.
- Resolução de 140 µm – microns.
- Matriz de imagem - 16 bits.
- Modo de Disparo: DEA (Detecção Automática de Exposição), Manual.
- Modo de Calibração: ACC (Controle Automático de Calibração), Manual.
- Tempo de Transferência de dados: Menos de 1 segundo.
- Tempo de ciclo de captura: 3 a 5 segundos.
- Tela: OLED.
- Bateria: 6 horas contínuas – Bateria de polímero de íon de lítio.

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

5

Fls. 483 - R

- Área ativa: 17 x 17 polegadas (430mm x 430mm).
- Matriz ativa sensor: **3072 x 3072 Pixels (9.4 m pixels) – 16 bits.**
- Interface com fio (saída de dados): Gigabit Ethernet / HDMI.
- Alimentação: elétrica: 100 -240V (50/60 Hz) | DC 22 – 24V, 5A – bivolt automático.
- Revestimento externo de fibra de carbono.
- Dimensões 460 x 461 x 15 mm.
- Peso com bateria: de 2,75 kg (sem bateria) 3,15 kg (incluindo bateria) ***o Mais leve do mercado***.
- Grau de proteção contra líquidos IPX4;
- Capacidade de carga de 150 kg sobre a superfície total do detector.



O detector digital é composto de um avançado sistema de Auto Calibração (Auto Calibration Control) permitindo que este seja instalado em qualquer tipo de aparelho de Raios-x, com grande facilidade e sempre com a mesma qualidade.



Com o sistema de Detecção Automática de Exposição (Automatic Exposure Detection) o detector sincroniza sem necessidade de comando ou interligação, captando a imagem e permanecendo em modo stand-by.

Software de Aquisição Z-View:

- Inserção dos dados do paciente com modos worklist, entrada manual e emergência, dispensando o preenchimento dos dados do paciente;
- Filtros de aquisição e definição dos protocolos de aquisição;
- Revisão da imagem adquirida;
- Lente de aumento e zoom digitais;
- Inserção de texto na imagem com ajuste dos tons de cinza e níveis de contraste;
- Pacote de medidas;
- Visualização em Mosaico;
- Protocolo DICOM (Storage, Print, Worklist e Media Creation);
- Supressão das linhas de grade;
- Possibilidade de gravar CD/ DVD com imagens;
- Licença Windows 10.
- Software de aquisição de imagens em português, com possibilidade de imprimir imagens em impressora DRY.
- Software com login e senha de modo a identificar o operador que realizou o exame e hierarquia entre administrador e operador
- Compatível com o sistema de PACS
- Possibilidade de exportação das imagens DICOM para outros formato como JPEG e gravação em mídia eletrônico.

Incluso/sistema de Hardware:


- Workstation para aquisição das imagens - Computador All in One "Dell" Inspiron 5490-M10S;
- Processador i5;
- Memória de 1TB – proporcionando um armazenamento de imagens muito grande e sem limite de quantidade por licença;
- Memória RAM de 12 GB;
- Monitor 24" polegadas Led Touch Screen.
- Nobreak de tecnologia de senoidal online e dupla conversão.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
010	001	UND	IMPRESSORA DRY LASER SECO PARA IMAGENS MÉDICAS MODELO: DRYPIX EDGE 8000 MARCA: "FUJIFILM"	R\$ 70.690,00	R\$ 70.690,00

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR
E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELLI

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

6


Fls. 484-R

		PROCEDÊNCIA: Japão REGISTRO ANVISA: 80022060088			
DESCRITIVO TÉCNICO					
IMPRESSOR DRY A LASER PARA IMAGENS MÉDICAS					
Especificações:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ O SISTEMA ECO-DRY da DRYPIX EDGE permite o processamento ecologicamente correto dos filmes Fujilm. ▪ Os filmes médicos para a DRYPIX empregam exclusivos solventes à base de água capazes de gerar imagens de cor neutra comparáveis a dos filmes processados em sistemas úmidos. ▪ As vantagens do ECO-DRY incluem a criação da nova tecnologia Liquid-Coating que elimina a necessidade dos solventes orgânicos nocivos, evitando os odores desagradáveis gerados por sua utilização. ▪ Imagem de alta qualidade. ▪ Alto desempenho 110 filmes/h (35 x 43 cm). ▪ Pannel sensível ao toque – praticidade no controle da operação. ▪ Luz ON/OFF – status do equipamento indicado pelo LED. ▪ Guia ilustrado – procedimentos de operação com vídeos demonstrativos. 					
Características Técnicas:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurações básicas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gerador de imagem: 01 (uma). ✓ Placa de memória: 01 (uma). ✓ Gavetas de filme: 03 (três). ▪ Tecnologia: fototermográfica. ▪ Filme aplicável: filme para impressão de imagem a seco DI-HL e DI-ML. ▪ Opções de tamanhos de filmes: 35,4 x 43,0 x 25,7 x 36,4 x 25,2 x 30,3 x 20,1 x 25,2. ▪ Capacidade de processamento máximo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprox. 110 filmes/h (35,4 x 43,0 cm). ✓ Aprox. 160 filmes/h (25,7 x 36,4 cm). ▪ Tamanho do pixel: 50µ (508dpi) / 100 µ (234dpi). ▪ Profundidade da imagem: 14 bit. ▪ Densidade máxima: 4,0* Filme específico para esta finalidade (DI-ML). ▪ Conectividade de rede: DICOM. ▪ Carregamento de filme: carregamento de luz do dia. ▪ Alimentação de filme: 03 (três) gavetas. ▪ Correção da densidade: automático. ▪ Capacidade de armazenamento de imagem: 1 GB. ▪ Interface de operação: pannel colorido sensível ao toque. ▪ Fonte de alimentação: 220V +/- 10%, 50/60 Hz, 12ª, monofásico, aterramento classe D. ▪ Ambiente de operação (ligado): temperatura (umidade): 15°C (40 -70% UR) – 30°C (15 – 70% UR) sem condensação. ▪ Ambiente de operação (desligado): temperatura (umidade): 0°C (10 – 90% UR) – 45°C (10 – 90% UR) sem condensação. 					
Dimensões externas e Peso:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Largura: 610 (24) mm. ▪ Profundidade: 630 (25) mm. ▪ Altura: 1.125 (44) mm. ▪ Peso: 125 Kg. 					
ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
011	008	UND	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MODELO: RN-11002 MARCA: "RENASCER" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80430259002	R\$ 1.440,00	R\$ 11.520,00
DESCRITIVO TÉCNICO					
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL					
Especificações:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20 mm. ▪ Encosto, assento, descansa pés integrado e braços estofados com espuma D26 Real revestido em Courvim. ▪ Movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral. ▪ Reclinável em até 04 posições. 					

Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz - Fone (43) 3029-1403 - CEP 86192-220 - Cambé - PR

E-mail: jaragua@jaraguamercantil.com.br | vendas@jaraguamercantil.com.br

CNPJ 13.390.706/0001-59 - Insc. Est. 905-52349-03



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

7

Fls. 489-R

- Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso.
 - Capacidade: até 150 Kg.
- Dimensões:**
- Comprimento: 1600 mm.
 - Largura: 750 mm.
 - Altura: 550 mm.
 - Largura Assento (Interno): 530 mm.


ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
013	035	UND	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MODELO: E-127 MARCA: "BIOLAND" PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 10410139003	R\$ 330,00	R\$ 11.550,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO**
- Especificações:**
- Utilização na testa;
 - Alarme sonoro e relógio;
 - Memória da última leitura;
 - Indicação do nível de bateria;
 - Desligamento automático;
 - Manual explicativo;
 - Capa de proteção do sensor medidor;
 - Leitura da temperatura em poucos segundos;
 - Termômetro de testa e ouvido;
 - Reconhecimento automático do local de medição (ouvido / testa).
 - Luz de fundo de três cores (Alarme de cor): Verde para normal, Amarelo para febre leve e Vermelho para febre alta.
 - Tempo de medição: 2 segundos;
 - Relógio - ativo no modo de espera (termômetro desligado) - Temperatura ambiente - ativa no modo de espera (termômetro desligado);
 - Visor de LCD grande e legível;
 - Indicação de som e cor para alta temperatura;
 - Recuperação da última medição;
 - Função de varredura - para medições da temperatura superficial do leite fervido, água do banho, etc.

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 435.466,00
******(Quatrocentos e e trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais)******

- 1. *** CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO *****
- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
 - **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
 - **Prazo de Entrega.....** : Até 10 (dez) dias, Conforme Edital.
 - **Frete.....** : Pago (Cif).
 - **I.P.I.....** : Incluso
 - **Garantia** : 12 (doze) meses integral c/defeito de FABRICAÇÃO, exceto o uso indevido ou desgaste natural do equipamento.
 - **Local de Entrega.....** : Almoxarifado Central
: Av. Abílio Espíndola Sobrinho, n.º 570 – Jardim Seriema
: CEP: 79.995-000 – CORONEL SAPUCAIA / MS.
 - **Responsabilidade Geral.....** : Jaraguá Mercantil – Eireli
: Rua Cerejeira, n.º 63 – Jardim Queiróz – Fone: (43) 3029-1403
: CEP: 86.192-220 – CAMBÉ / PR.



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Fls. 486.R

2. *****PROPONENTE*****

- Jaraguá Mercantil – Eireli
- Rua Cerejeira. n.º 63 – Jardim Queiróz
- CEP: 86.192-220 – Cambé/PR.
- CNPJ: 13.390.706/0001-59
- Insc. Estadual: 90.552.349-03
- Insc. Municipal: 15.796
- Fone: (43) 3029-1403
- E-mail: vendas@jaraguamercantil.com.br / jaragua@jaraguamercantil.com.br

3. *****DADOS BANCÁRIOS*****

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0768-4
- C/corrente: 48036-3
- Favorecido: Jaraguá Mercantil – Eireli
- CNPJ: 13.390.706/0001-59

4. *****DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (P/ASSINATURA DO CONTRATO)*****

- Nome: Laudinei Antonio Campos
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Representante Comercial
- Endereço: Rua Elis Regina, n.º 217 – Jardim Bavária – CEP: 86082-015 - LONDRINA/PR.
- CPF: 857.114.549-00
- RG: 4.086.585-3 SESP/PR.
- Data de Nascimento: 28/07/1972

5. *****DECLARAÇÕES*****

- Os preços acima propostos contempla todos os custos diretos ou indiretos, já estão inclusos impostos, seguros, taxas, frete e quaisquer outros encargos, pertinentes ao fornecimento dos produtos licitados. Exceto adequação de sala e ou realização de obras de engenharia.
- Concordamos com todas as condições do presente Edital, bem como seus anexos.

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui,

ATENCIOSAMENTE

JARAGUÁ MERCANTIL – EIRELI
Laudinei Antonio Campos
CPF: 857.114.549-00
RG: 4.086.585-3 SESP/PR
Representante Legal

13.390.706/0001-59
Inscr. Est.: 90.552.349-03
JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI
RUA CEREJEIRA, 63
JARDIM QUEIROZ
CEP 86192-220 - CAMBÉ - PR

**ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS**

ORGÃO LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS	
PROCESSO/MODALIDADE:		0105/2020 - PREGÃO Nº 0047/2020	TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13022.375000/1190-02, ASSIM DEFINIDOS PELO ART. 3º E 18-A, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL SAPUCAIA-MS, EM CONFORMIDADE COM AS DESCRIÇÕES ELECADAS NOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA EDITAL (ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS / ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA			
PROPONENTE:		JARAGUA MERCANTIL EIRELI	CNPJ/CPF: 13.390.706/0001-59
ENDEREÇO:		RUA CEREJEIRA Nº 63	BAIRRO: JARDIM QUEIROZ
CIDADE/UF:	CEP:	TELEFONE/FAX:	
CAMBÉ/PR	86.192-220	(43) 3029-1403	
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGENCIA/CONTA):		VALIDADE DA PROPOSTA:	
BANCO DO BRASIL (001) AG: 0768-4 C/C: 48036-3		60 DIAS	
E-MAIL		LOCAL E DATA:	
jaragua@jaraguamercantil.com.br			

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO	MARCA OFERTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	32753	ANDADOR FIXO PARA IDOSOS DOBRÁVEL: É UM EQUIPAMENTO EM ALUMÍNIO UTILIZADO POR PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER (IDOSO), AUXILIANDO EM CASOS DE DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - ALTURA AJUSTÁVEL - DOBRÁVEL - ALTURA: DE 78 A 96 CM - CAPACIDADE: 100 KG.	UN	4,000	321,67		0,00	0,00
0001	2	21744	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHAO DE FISIOTERAPIA, BASE DE POLIETILENO, RESISTENCIA BLINDADA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 70 GRAUS, LÂMPADA PILOTO, TAMPO PROTETOR DA RESISTENCIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 3000W-220VAC E 2500 EM 110VAC, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B, DIMENSÕES: ALTURA 87CM E DIAMETRO 24CM	UN	1,000	1.643,28		0,00	0,00
0001	3	32771	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL: SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO COM 8 NÍVEIS. COM COMPUTADOR QUE CONTROLA CALORIAS, DISTÂNCIA, ODÔMETRO, PULSO, TEMPO, VELOCIDADE. ASSENTO AJUSTÁVEL. SUPORTA ATÉ 150KG.	UN	1,000	3.968,17		0,00	0,00
0001	4	22386	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONADO IDEAL PARA SANITARIO E CHUVEIRO, ASSENTO SANITRARIO REMOVIVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON.	UN	4,000	513,42		0,00	0,00

Handwritten signature and initials:
 BA
 R

✓

0001	5	10823	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X, COM QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS, EM DURALUMÍNIO, ASSENTO EM NYLON, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE 38CM, ENCOSTO NYLON, LARGURA 38CM, ALTURA 40CM, TILT AUSENTE, RODAS DIANTEIRAS EIXO REMOVÍVEL, PNEU INFLÁVEL, RODAS TRASEIRAS EIXO REMOVÍVEL, RODAS ANTI TOMBO, APOIO DE CABEÇA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E NÃO ENLEVAVÉL, APOIO PARA PANTURRILHA FAIXA, PEDAL GIRATÓRIO, ARO DE PROPULSÃO LISO, PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM PLÁSTICO E COM TAMPA, FREIOS BARRA SUPERIOR.	UN	5,000	3.508,67		0,00	0,00
0001	6	29134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODIZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	1,000	16.012,78	MARCA INDÚSTRIA / 1053	16.010,00	16.010,00
0001	7	19183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	4,000	2.516,28	RENASCER / RN-04020	2.509,00	10.036,00
0001	8	32678	DESFRIBILADOR PORTÁTIL DEA - PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP56, GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O, MODO DE OPERAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA) TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA PLUGUE DE REDE, TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB) CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 40°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75%, PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 °C A 50 °C, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO 10% A 95%, SEM CONDENSAÇÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C A +50° C; DIMENSÃO 295 X 225 X 155 MM, PESO APROXIMADAMENTE 1,9KG.	UN	1,000	13.133,73		0,00	0,00

v

0001	9	32764	<p>EQUIPAMENTO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL DIGITAL</p> <p>GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA CONTROLADO POR MICROPROCESSADORES, EM POTENCIAL CONSTANTE. ALIMENTAÇÃO 220/380V, 50/60HZ; TRIFÁSICO POTÊNCIA MÍNIMA DE 50KW; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE +/- 10%; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X; INDICADORES DE AUTO DIAGNÓSTICO PARA FALHAS DO SISTEMA; MESA DE COMANDO COM AJUSTES DE KV, MA, TEMPO E MAS; AJUSTE DE KV DE 30 A 150KV EM PASSOS DE 1KV; AJUSTE DE MA DE PELO MENOS 10 A NO MÍNIMO 630MA; VARIAÇÕES DE MAS DE 0,1 A NO MÍNIMO 630MAS; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,001 A 9 SEGUNDOS OU MAIOR; (POSSIBILITANDO QUE O NÍVEL DE RADIAÇÃO PARA O PACIENTE E USUÁRIO SEJA O MENOR POSSÍVEL) MÍNIMO DE 500 TÉCNICAS PROGRAMÁVEIS E EDITÁVEIS (OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO EM TORNO DE 60% E POSSIBILITANDO UM GAMA MUITO MAIOR DE EXAMES) INDICAÇÃO DE EXPOSIÇÃO POR SINAL SONORO E LUMINOSO.</p> <p>TUBO DE RAIOS-X COM FOCOS 0,6MM E 1,2MM; POTÊNCIA NOMINAL DO TUBO NO MÍNIMO E7884X ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DO ÂNODO DE PELO MENOS 140KHU; CAPACIDADE TÉRMICA DO CONJUNTO EMISSOR DE PELO MENOS 1200KHU.</p> <p>COLUNA PORTA TUBO TIPO CHÃO CHÃO COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 230CM; MOVIMENTO GIRATÓRIO DO EIXO DA COLUNA DE +/- 180°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS ATRAVÉS DE BOTÕES; ROTAÇÃO DO TUBO +/- 180°; BRAÇO TELESCÓPICO DE 30CM; GONIÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO TUBO.</p> <p>MESA RADIOGRÁFICA TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO TRANSVERSAL MÍNIMO DE 85CM E LONGITUDINAL MÍNIMO DE 23CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS POR PEDAL; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO 200CM DE COMPRIMENTO X 75CM DE LARGURA X 70CM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 300KG; POTTER BUCKY OSCILANTE, BANDEJA COM SISTEMA DE</p>	UN	1,000	315.666,67	CDK / PIXX / DIAFIX HF / PIXXGEN CORPORATION	315.660,00	315.660,00
0001	10	32306	<p>IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.</p> <p>SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3,0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS, PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS; TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 35X35CM OU 35X43CM.</p>	UN	1,000	70.699,11	FUJIFILM / DRYPIX EDGE 8000	70.690,00	70.690,00

✓

0001	11	28309	POLTRONA HOSPITALAR; DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATE 120 KG.	UN	8,000	1.444,44	RENASCER / RN-11002	1.440,00	11.520,00
0001	12	32754	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE RESERVA: COM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS (FILTROS), VAZÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS/HORAS, CONDUTIVIMETRO DIGITAL, FORNECENDO NO MÍNIMO ÁGUA TIPO II PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA.	UN	1,000	7.173,32		0,00	0,00
0001	13	32541	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR O G-TECH, SEM CONTATO COM A PELE, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA COM GARANTIA DE 1 ANO	UN	35,000	334,17	BIOLAND / E-127	330,00	11.550,00
0001	14	32673	TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL GEL COM DISPENSER E PEDAL ALTURA 102CM X LAGURA 35CM TUBO DE FERRO 20/20 BASE DE CHAPA 9MM PINTURA EPÓXI AUTOMOTIVA CONTÉM UM REEFL 500ML	UN	16,000	312,22		0,00	0,00
0001	15	32755	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, CICLADO A PRESSÃO. É INDICADO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA EM PROCEDIMENTOS E TRANSPORTES INTRA-HOSPITALAR (CTIS E PRONTOS-SOCORROS) E EXTRA-HOSPITALAR (EM AMBULÂNCIAS E HELICÓPTEROS) E NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (IPPV). PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM ADULTOS E CRIANÇAS (ACIMA DE 10KG). UTILIZA UM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DURANTE A FASE INSPIRATÓRIA, INDEPENDENTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO AJUSTADO, OCASIONANDO UMA NEBULIZAÇÃO EFICIENTE MESMO COM UTILIZAÇÃO DE BAIXO FLUXO. COMPATÍVEL COM VIA AÉREA UTILIZADA EM UTI PARA VENTILAÇÃO PROLONGADA. POR SER NÃO MAGNETIZÁVEL, E UTILIZADO EM SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ECONÔMICO: LIBERA O FLUXO DO NEBULIZADOR SOMENTE NA FASE INSPIRATÓRIA; POSSUI VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO INTERNA QUE IMPEDE VARIAÇÕES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS, DISPENSADO O USO DE VÁLVULAS ESTABILIZADORAS EXTERNAS. SEGURO: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE BAROTRAUMAS; POSSUI FILTRO PARA ADMISSÃO DE AR AMBIENTE; PROJETADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10KG) E ADULTOS. FLUXO (TI),TEMPO EXPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA), PRESSÃO INSPIRATÓRIA (VOLUME),ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA, CICLO MANUAL, VÁLVULA LIGA/DESLIGA, FIO2,PEEP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MECANISMO; PNEUMÁTICO, GERADORES; FLUXO (OXIGÊNIO A 100%) E PRESSÃO (OXIGÊNIO A 40%); MODO DE VENTILAÇÃO: CMV(CONTROLADA), AMV(ASSISTIDA), CMV+AMV E MANUAL; PEEP: AJUSTÁVEL DE 0 A 20 CM DE H2O; FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL PODENDO VARIAR DE 3,5 A 5,0 KGF/ CM²;PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0,1 A 15 SEGUNDO; FLUXO MÁXIMO: 60L/MIN(OXIGÊNIO A 100%) OU 90L/MIN; INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 6 A 60 CICLOS POR MINUTO (CPM) (OXIGÊNIO A 40 %); CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO : 40%(SEM CARGA A JUSANTE) OU 100%, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REGULADA EM 75 CM H2O.	UN	2,000	45.333,33		0,00	0,00
VALOR TOTAL								R\$ 435.466,00	

V

A

R

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

NOME E ASSINATURA



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI
C.N.P.J.: 13.390.706/0001-59
Rua Cerejeira, 63 - Jd. Queiroz
Cambé - PR

13.390.706/0001-59

Inscr. Est.: 90.552.349-03

JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI

RUA CEREJEIRA, 63

JARDIM QUEIROZ

CEP 86192-220 - CAMBÉ - PR



v

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Fls. 492. R

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI		
CNPJ	20.541.548/0001-56	Autorização	8.13.253-7
Produto	cama hospitalar		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

CAMA HOSPITALAR 1001

CAMA HOSPITALAR 1002

CAMA HOSPITALAR 1004

CAMA HOSPITALAR 1005

CAMA HOSPITALAR 1006

CAMA HOSPITALAR 1007

CAMA HOSPITALAR 1008

CAMA HOSPITALAR 1009

CAMA HOSPITALAR 1053

CAMA HOSPITALAR 1080

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Cama Hospitalar
Registro	81325370001
Processo	25351.416839/2017-63
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: MARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - BRASIL

Fig. 493.R



47 3288.4746

comercial@marcahospitalar.com.br
www.marcahospitalar.com.br



Cama de parto PPP – 1053

Descrição:

Cama hospitalar motorizada para parto de uso em quarto de alojamento conjunto.

Tem a finalidade de cama pré-parto, parto e pós parto.

Transforma-se em cama hospitalar para adequar-se as condições necessárias do parto natural.

Nas suas diversas alternativas, retorna à condição original de cama para repouso da mãe após o parto, evitando a transferências da parturiente entre o quarto e sala de parto.

Proporciona maior conforto e individualidade.

Os movimentos das perneiras, apoio de pés e braço de esforço são reguláveis através de manipuladores, facilitando assim a regulagem em varias alturas e posições.

Proporciona assim maior comodidade e ergonomia para a mãe.

REF: 1053 Categoria: Camas Manuais

Pesquisar produtos... Pesquisa

- > Acessorios
- > Mesas
- > Armarios
- > Camas Manuais
- > Camas Motorizadas
- > Carros
- > Guinchos
- > Macas
- > Poltronas
- > Contato

Descrição Avaliações (0)

Descrição

Código: MTC1053

Estrutura: Em tubos retangulares de aço carbono de 30X50X1,5mm;

Leito: Em chapa de aço carbono de 1,2mm dobrada com reforços em tubos de 20X30X1,2mm;

Cabeceiras: Em poliuretano termoplástico de alta resistência, com opções de cores de acabamento;

Grades: Em poliuretano termoplástico de alta resistência, com opções de cores de acabamento;

Acionamento: Acionamento através de cremalheira;

Movimentos: Elevação dorsal.

Acessórios :

01 par de porta coxas com base em aço inoxidável e apoio de pernas em poliuretano revestido com espuma e corvim;

01 par de calcanheiras em aço inoxidável revestido com espuma e corvim;

01 par de braços para esforço em aço inoxidável;

01 dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável.

01 conjunto de colchão em espuma de PU de alta densidade, tripartido com 15cm de altura, revestimento em corvim e zíper para higienização.

01 escadinha de 2 degraus.

Acabamento: Acabamento em pintura eletrostática a pó com sistema de tratamento antiferruginoso, gerando grande resistência a esforços mecânicos e corrosivos;

Rodízios: Rodízios de 4" decorativos com rodagem dupla, na cama e no complemento, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal e cada parte;

Capacidade máxima: 150 Kg

Dimensões

Altura 800mm

Largura Útil: 800mm

Largura Total: 900mm

Comprimento Útil: 1900mm

Comprimento Total: 2000mm

Produtos Relacionados



Cama Hospitalar - 1004



Cama Hospitalar - 1005S



Cama Hospitalar - 1005



Cama Hospitalar - 1001

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Fls. 494. R

Nome da Empresa	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		
CNPJ	04.198.372/0001-25	Autorização	8.04.302-5
Produto	FAMILIA DE CARROS MACAS		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

RN04018 CARRO PADIOLA ESTRUTURA E LEITO EM CHAPA C/PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;

RN04018-A CARRO PADIOLA COM MOLEJO ESTRUTURA E LEITO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;

RN04018-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO LEITO EM CHAPA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;

RN04023 CARRO PADIOLA COM ELEVAÇÃO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO EM CHAPA INOX COM GRADES E SUPORTE DE SORO;

RN04040 CARRO MACA PARA EMERGÊNCIA

RN 04019 CARRO PADIOLA ESTRUTURA E LEITO EM CHAPA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ SEM GRADES E SEM SUPORTE DE SORO;

RN 04019-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO LEITO EM CHAPA C/PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ SEM GRADES E SEM SUPORTE DE SORO;

RN 04020 CARRO PADIOLA ESTRUTURAC/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E COM SUPORTE DE SORORN 04020I CARRO PADIOLA ESTRUTURA INOX LEITO ESTOFADO COM GRADES E COM SUPORTE DE SORO;

RN 04020-OB CARRO PADIOLA PARA OBESO ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO COM GRADES E SUPORTE DE SORO;

RN 04021 CARRO PADIOLA ESTRUTURA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ LEITO ESTOFADO SEM GRADES E SUPORTE

« 1 2 3 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
	Nenhum Arquivo Encontrado(a)	✓



Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: renascer@sercomtel.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br

Fis. 495. X



RN04020 – CARRO PADIOLA ESMALTADO, LEITO ESTOFADO, COM GRADES



Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm
 - Leito fixo em chapa de MDF de 15mm, com espuma D26R revestido em Courvim
 - Cabeceira regulável através de cremalheira
 - Grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
 - Pára-choque de proteção na cabeceira e pesseira do leito
 - Suporte para soro com 02 ganchos inox (T)
 - Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal
 - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso
- Dimensão aproximada: 1900 x 600 x 800 mm – Capacidade Aprox.: Até 110Kg
Registro MS: 80430259010

- Opcional: Suporte para cilindro de Oxigênio
- Opcional: Pés com rodízios de 5", 6" ou 8" em polipropileno, com freio em diagonal.

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431
CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

LOTE 01 - ITEM: 009

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Fls. 490-K

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP		
CNPJ	04.864.204/0001-21	Autorização	8.01.196-1
Produto	EQUIPAMENTO FIXO PARA RAIOS-X		

Modelo Produto Médico

DIAFIX DYNAMIC; DIAFIX DYNAMIC PLUS

DIAFIX HF

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	ROTULAGEM ANVISA - FAMÍLIA DIAFIX.PDF	1829189/20-4 - 09/06/2020 - 04:55
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MU-05 - RV 02 - MANUAL DO USUÁRIO - FAMÍLIA DIAFIX.PDF	1829189/20-4 - 09/06/2020 - 04:55

Nome Técnico	Aparelho Fixo para Raio-X
Registro	80119610007
Processo	25351.786901/2014-77
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA-EPP - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	23/03/2025

Voltar

CARACTERÍSTICAS

Comando/ Gerador de Alta Tensão

- Mesa de comando com painel em membrana *soft touch* para visualização das técnicas aplicadas e ajustes de kV, mA, tempo e mAs;
- Técnicas programáveis e editáveis;
- Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso;
- Gerador em alta frequência controlado por microprocessadores;
- Alimentação 220/380V trifásico 50/60Hz. Opcional: Alimentação monofásica;
- Potência: de 16kW a 80kW;
- Capacidade: de 200mA a 1000mA;
- Sistema PWM.

Tubo De Raios-X

- Tubo de raios-x Toshiba de alta performance, inserido em unidade selada de alumínio totalmente blindada contra radiação;
- Ponto focal a partir de 0,3mm a 2,0mm.

Coluna Porta Tubo

- Deslocamento longitudinal;
- Movimento giratório do eixo da coluna;
- Freios eletromagnéticos;
- Braço telescópico de 30cm;
- Goniômetro para indicação da angulação do tubo.

Mesa Radiográfica

- Tampo flutuante com deslocamento transversal e longitudinal, com freios eletromagnéticos;
- Potter *bucky* oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18cm a 35x43 em qualquer direção;
- Tampo flutuante, móvel ou fixo;
- Grade antifuusora de alta resolução de 103 a 215 linhas.

Bucky Mural

- Potter *bucky* oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18cm a 35x43 em qualquer direção;
- Grade antifuusora de alta resolução de 103 a 215 linhas.

Colimador Luminoso

- Colimador manual;
- Temporizador de 30 a 60 segundos para desligamento automático;
- Luz de LED.

Opcionais

- Gerador a bateria de 16kW a 50kW;
- Controle automático de exposição (AEC);
- Detetor digital - DR, fixo ou portátil (com cabo ou Wi-Fi);
- Alim. Vação Monofásica, Bifásica ou Trifásica (Gerador SHFR);
- Mesa Elevatória;
- Acessórios.



Empresa comprometida com resultados.
Sua compra é o que temos de mais valioso.


Rua Orense 783, Parque das Jaboicabeiras, Diadema/SP
+55 (11) 4055-1011 | www.cdk.com.br | vendas@cdk.com.br



Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

DIAFIX HF[®]
DIAFIX HF - DR[®]

Fls. 492 K

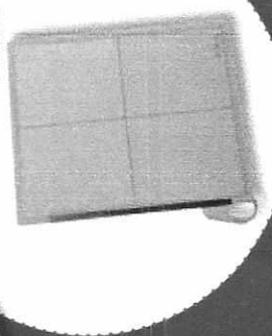

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	novomédica comercio importação e exportação ltda		
CNPJ	00.846.380/0001-80	Autorização	1.03.325-1
Produto	PIXX WI-FI		

Modelo Produto Médico

PIXX 1212

PIXX 1417

PIXX 1717

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Digitalizador de Imagens Radiograficas
Registro	10332510020
Processo	25351.592745/2017-90
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: PIXXGEN CORPORATION - CORÉIA DO SUL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Fis. 499.K



NOVOMÉDICA[®]
inovação em medicina

Redefinindo a Inovação através
do valor e desempenho!

DETECTORES DIGITAIS



TFT Inquebrável

Flexível TFT

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the letters 'F', 'S', 'R', and 'B' are written vertically.
At the bottom right, there are several scribbles and a checkmark.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

LOTE 01 - ITEM: 010

Detalhes do Produto


Nome da Empresa	FUJIFILM DO BRASIL LTDA		
CNPJ	60.397.874/0001-56	Autorização	8.00.220-6
Produto	Impressora a Laser a Seco para Imagens Médicas Fuji DRYPIX EDGE		

Modelo Produto Médico

DRYPIX 8000

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
IMAGENS DO(S) PRODUTO(S)	DryPix Edge - Imagens.pdf	2213638/20-9 - 09/07/2020 - 03:57
FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO OU CADASTRO	DryPix Edge - Formulario.pdf	2213638/20-9 - 09/07/2020 - 03:57

Nome Técnico	Impressora para Imagens Medicas
Registro	80022060088
Processo	25351.275712/2018-69
Fabricante Legal	• FABRICANTE: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE



 Voltar



Fls. 501 - R

FUJIFILM
Value from Innovation

IMPRESSORA À LASER

LANÇAMENTO

DRYPIX EDGE

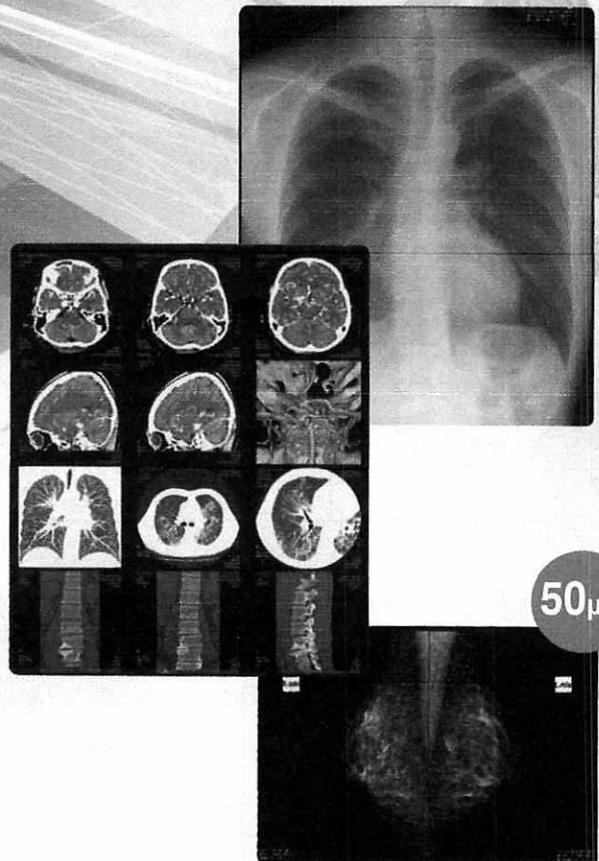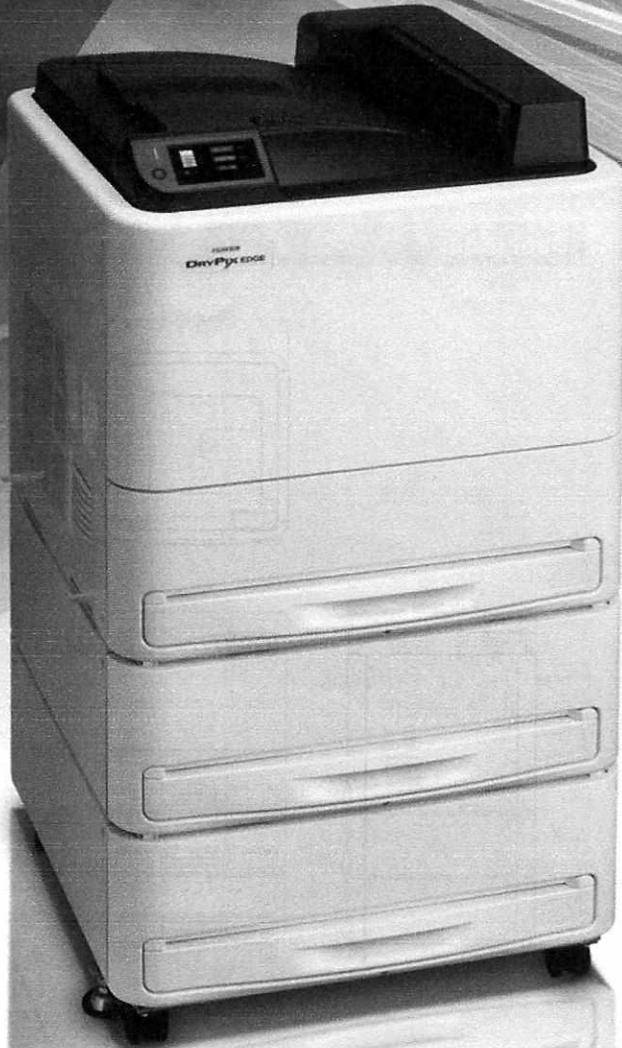

50µm

Imagens de alta qualidade para maior versatilidade

Com o exclusivo Sistema ECO-DRY* (solvente à base de água)

■ Alto desempenho

110
Filmes /h
(35 x 43 cm)

■ Painel sensível ao toque

Praticidade no controle da operação

■ Luz ON/OFF

Status do equipamento indicado pelo LED

■ Guia ilustrado

Procedimentos de operação com vídeos demonstrativos

Handwritten signatures and scribbles in the bottom right corner.

LOTE 01 - ITENS 011

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Fls. 002-V

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		
CNPJ	04.198.372/0001-25	Autorização	8.04.302-5
Produto	FAMÍLIA DE CADEIRA PARA DOADOR		

Modelo Produto Médico

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RN06002(ESTRUTURA ESMALTADA); POLTRONA MULTIMED RN11001; POLTRONA P/COLETA ARTIULÁVEL RN11004; CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO ESMALTADA RN06005

POLTRONA RECLINÁVEL DE DESCANSO - RN11002

POLTRONA RECLINÁVEL DE DESCANSO PARA OBESO - RN11002OB

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Cadeira Para Doador
Registro	80430259002
Processo	25351.622961/2008-86
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE


 Voltar



Renascer
móveis hospitalares

Renascer Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA

Email: contato@renascermoveishospitalares.com.br

Site: www.renascermoveishospitalares.com.br

Fls. 503 - R



RN11002 – POLTRONA RECLINÁVEL DE DESCANSO



Imagem Ilustrativa

- Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm
 - Encosto, assento, descanso pés e braços estofados com espuma D26 Real revestido em Courvim
 - Movimentos simultâneos do encosto, descanso pés e braços comandados por meio de alavanca lateral
 - Reclinável em até 04 posições
 - Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso
- Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm – Capacidade Aprox.: Até 150Kg
Largura Assento (Interno): 530 mm
Registro MS: 80430259002

Rua Tereza de Souza, nº. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431

CNPJ: 04.198.372/0001-25 – ICMS: 90.227.124-43

LOTE 01 - ITEM: 013

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Fls. 504. K

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	78.515.210/0001-00	Autorização	1.04.101-3
Produto	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO		

MEDIDA CAUTELAR


Modelo Produto Médico

E 127

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO
Registro	10410139003
Processo	25351.429642/2011-69
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOLAND TECHNOLOGY LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE


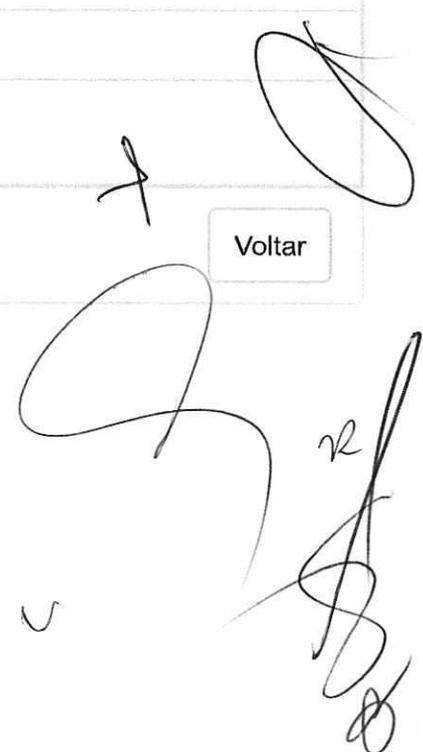
+ 
Voltar

bioland[®]

Termômetro Digital Infra-vermelho

de testa e ouvido (4 em 1) Modelo E127

Medição em
2 segundos

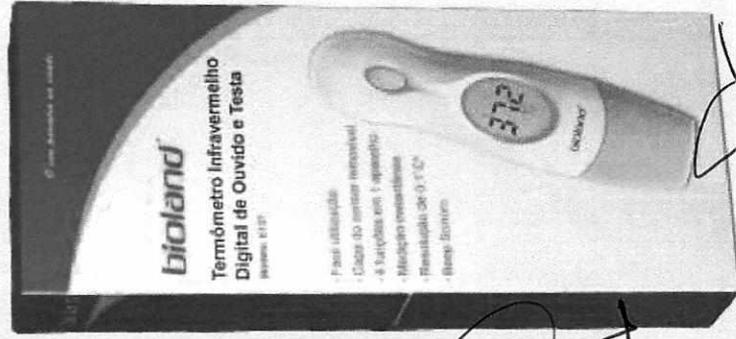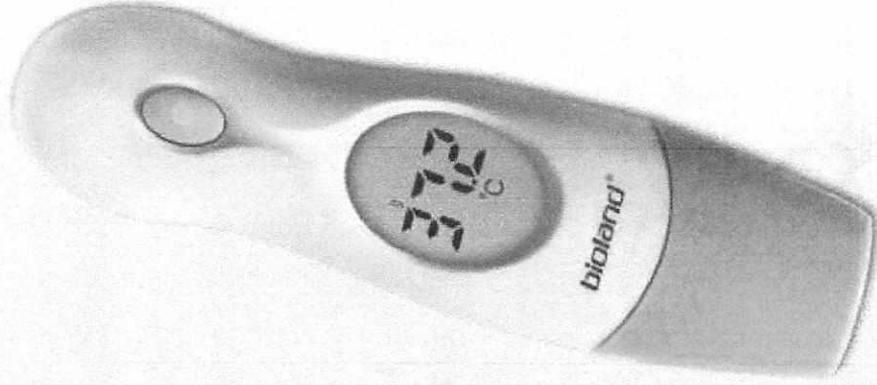

- Utilização na testa e ouvido
- Medição da temperatura ambiente
- Alarme sonoro e relógio
- Memória da última leitura
- Indicação do nível da bateria
- Desligamento automático
- Manual explicativo
- Capa de proteção

50

ANVISA R

Fls. 505.R